BG

B.Well
Caring for everyone

BG Наръчник за употреба

PRO-30

Полу-автоматичен апарат за кръвно налягане с монитор

B.WELL SWISS CONTROLLED

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че закупихте апарата за кръвно налягане B.Well PRO-30. Създаден за удобно и лесно използване, този апарат позволява бързо и надеждно измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане, както и сърдечната честота, използвайки осцилометричен метод на работа.

Важни предимства на PRO-30

- Съвременната технология Intellect Classic.
- Светлинен индикатор според Европейското общество по хипертония (ESH).
- Памет за последното измерване.
- Разгъващ се анатомичен маншет за ръката, който може да се пере.
- Индикатор за състоянието на батерията.
- Автоматично изключване.
- Това устройство е лесно за употреба и работи с точност доказана чрез клинични проучвания.

2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

Таблица за класифициране на стойностите на кръвното налягане (mmHg) съгласно Европейското дружество по хипертония (ESH)

Диапазон	Систолично кръвно налягане	Диастоличното кръвно налягане	Мерки
3-та степен: тежка хипертония	По-високо или равно на 180	По-високо или равно на 110	Спешно потърсете медицинска помощ
2-ра степен: умерена хипертония	160-179	100-109	Консултирайте се с Вашия лекар незабавно
1-ва степен: лека хипертония	140-159	90-99	Консултирайте се с Вашия лекар
Високо – нормално	130-139	85-89	Консултирайте се с Вашия лекар
Нормално	По-ниско от 130	По-ниско от 85	Проверете сами
Оптимално	По-ниско от 120	По-ниско от 80	Проверете сами

ⓘ **ЗАБЕЛЕЖКА:** Покажете измерените стойностина вашия лекар. Никога не използвайте резултатите от измерванията за да променяте дозите на лекарствата, предписани от вашия лекар.

3. СЪДЪРЖАНИЕ И ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

Модел PRO-30

Систолично налягане
Диастолично налягане
Пулс

- Сърдечен пулс Започване
- на измерване Търсене на
- нулата Изчерпване на
- батерията Изчерпана
- батерия
- Откриване на аритмия
- Ниво на кръвното налягане

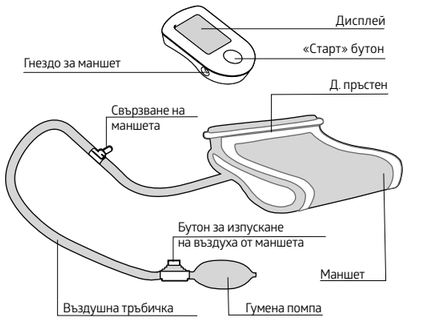

4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият монитор за кръвно налягане е предназначен за използване от медицински специалисти или в домашни условия и представлява неинвазивна система за измерване на кръвно налягане – диасистолично и систолично кръвно налягане и на пулса на възрастни хора чрез използване на неинвазивна техника, при която надуваем маншет се увива около горната част на ръката. Обиколката на маншета е от 22 до 48 сантиметра.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препоръчително е хора с тежки аритмии да не използват цифровия автоматичен апарат за измерване на кръвното налягане.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Преди да използвате апарата прочетете цялата информация в ръководството за работа, както и всяка друга литература в кутията.
2. Стойте спокойни и се отпуснете в продължение на 5 минути преди да измерите кръвното налягане.
3. Маншетът трябва да бъде поставен на нивото на сърцето.
4. По време на измерване не говорете и не движете тялото и ръката си.
5. Всеки път измервайте кръвното на лявата си ръка.
6. Отпуснете за поне 1 до 1,5 минути между измерванията, за да дадете възможност на кръвообращението на ръката да се възстанови. Продължителното използване на маншета с въздух (налягането на маншета надвишава 300 mmHg или поддържа над 15 mmHg за по-дълго от 3 минути) може да доведе до подуване на ръката.
7. Консултирайте се с Вашия лекар, ако имате някакви съмнения относно случаите описани по-долу:
   1) Прилагане на маншета върху рана или заболявания с възпаление;
   2) Прилагане на маншета на крайник, с интраваскуларен достъп или терапия, или артериовенозен (A-V) шънт;
   3) Прилагането на маншета на ръката от страната на мастектомия;
   4) Използването едновременно с друго медицинско оборудване за наблюдение на същия крайник;
   5) Трябва да се провери циркулацията на кръвта на потребителя.
8. ⚠ Този дигитален апарат за измерване на кръвното налягане е предназначен за възрастни и не трябва да се използва при бебета или малки деца. Консултирайте се с Вашия лекар или други специалисти по здравни грижи преди да използвате апарата при по-големи деца.
9. Не използвайте този уред в движещо се превозно средство. Това може да доведе до отчитане на неточни резултати.
10. Измерванията на кръвното налягане, определени от този монитор, са равностойни на тези, получени от специалист, който използва маншет/стетоскоп за прослушване, в границите, определени от Американския национален институт по стандартизация на електронни или автоматични сфигмоманометрични апарати.
11. Информацията относно потенциални електромагнитни или други смущения между монитора на апарата или други устройства, заедно със съветите по отношение избягването на подобна намеса, моля вижте в част „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ".
12. Моля, не използвайте маншет, различен от предоставения от производителя, в противен случай, това може да доведе до биосъвместима опасност и до допускане на грешки при измерването.
13. ⚠ Апаратът може да не изпълни указаните действия или да предизвика опасност за сигурността, ако се съхранява или използва извън определените температура и влажност, посочена в спецификациите.
14. ⚠ Моля, не позволявайте маншетът да бъде използван от друг заразен човек, като така ще се избегне разпространението на инфекции.
15. Моля, имайте предвид, че промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с апарата.
16. Този уред е изпробван и съответства на изискванията за цифрови устройства от клас B, съобразно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при използване в домашни условия. Този уред генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретната инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да бъде определено чрез включване на апарата, потребителят може да се опита да коригира смущенията като използва една или повече от следните мерки:
   а. Преориентирайте или преместете антената на приемника.
   б. Увеличете разстоянието между апарата и приемника.
   в. Свържете апарата към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
   г. Консултирайте се с дистрибутор или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

7. НАСТРОЙКА И РАБОТА НА АПАРАТА

7.1. Зареждане на батерията

а. Отворете капака на батерията на гърба на монитора.
б. Заредете четири батерии размер "AAA". Моля, обърнете внимание на полярността.
в. Затворете капака на батерията.
г. След като сте поставили батериите или изключите монитора, дисплеят не показва нищо. Сега мониторът е в изключена позиция.

⚠ Ако мониторът показва символ за батерия ▭, докато е включен, батериите са на привършване.
⚠ Ако батериите са се изчерпали символът за батерията ▭ ще мига за около 10 секунди. След което мониторът винаги ще показва символ за батерия ▭
и няма да може да се отвори. Моля, сменете всички батерии с нови.
⚠ Презареждащите се батерии не са подходящи за този апарат.
⚠ Извадете батериите, ако мониторът няма да се използва в продължение на месец или по-дълъг период, за да се избегне съответното увреждане и протичане на батерията.
⚠ Внимавайте да не попадне течност от батерията в очите Ви. Ако все пак това се случи, незабавно изплакнете обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.

Мониторът, батериите и маншетът, трябва да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби, ако няма да се използват повече.

7.2. Свързване на маншета с апарата

Поставете тръбичката за въздуха плътно в отвора отстрани на монитора. Уверете се, че щепселът е правилно поставен, за да се предотврати изтичане на въздух по време на употреба.

⚠ Избягвайте компресия или ограничаване на свързващата тръбичка по време на измерването, което може да предизвика грешка или нараняване, поради непрекъснатото налягане на маншета.

7.3. Поставяне на маншета

а. Издърпайте края на маншета през металната халка (маншетът вече е предварително опакован с такава), обърнете го навън (далеч от тялото) и го пристегнете като затворите здраво велкро закопчалката.
б. Поставете маншета около гола ръка 1-2 см над лакътя.
в. Заемете седнала позиция, вдигнете длан и поставете върху равна повърхност като например върху маса. Поставете маншета около гола ръка като долният му край е 1-2 см над лакътя. Червеният маркер (знакът за артерията) трябва да бъде над нивото на лакътя.
г. Маншетът трябва да покрие плътно ръката, в противен случай резултатът от измерването няма да бъде адекватно. Не се препоръчва поставяне на маншета върху дрехи.





7.4. Провеждане на измерване

Преди измерването:

- Избягвайте хранене, пушене, както и всички форми на напрежение директно преди измерване. Всички тези фактори влияят върху резултатите. Опитайте се да намерите време да се отпуснете в кресло в тиха и спокойна атмосфера за около десет минути преди измерването.
- Съблечете дрехите, които пристягат горната част на ръката. Опитайте се да извършите измерването винаги на една и съща ръка.
- Опитайте се да извършите измерванията редовно по едно и също време на деня, тъй като кръвното налягане се променя през денонощието.

Измерване в удобна седнала позиция

а. Седнете със стъпала на пода и не кръстосвайте краката си.
б. Поставете дланта си обърната нагоре пред себе си върху плоска повърхност например бюро или маса.
в. Средата на маншета трябва да бъде на нивото на сърцето.



Измерване в легнала позиция

а. Легнете по гръб.
б. Поставете лявата си ръка до себе си с обърната нагоре длан.
в. Маншетът трябва да се постави на нивото на сърцето.



Често срещани източници на грешки:

- Движение по време на измерване
- Артерията на ръката се намира значително по-ниско (по-високо) от сърцето
- Маншетът не ви е по мярка
- Разхлабен маншет или странично издуващо се въздушно пространство

ⓘ **Забележка:** При повторно измерване кръвта се натрупва в съответната ръка, което може да доведе до грешно измерване на резултатите. Затова правилно извършените измервания на кръвното налягане трябва да се повторят след едноминутна пауза.

7.5. Отчитане стойностите на кръвното налягане

След прилагане на маншета и след като тялото Ви е в удобна позиция, натиснете бутон "START". Чува се звуков сигнал и всички символи на дисплея се показват за самодиагностика. Вижте Схема 5. Моля, свържете се с центъра за обслужване, ако липсва някой от елементите.

а. Дисплеят моментално ще покаже последното измерване съхранено в паметта. Вижте Схема 5-1. Ако мониторът няма данни съхранени в паметта, дисплеят ще покаже "0" за кръвно налягане и за скоростта на пулса. Вижте Схема 5-2.

Схема 5 Схема 5-1 Схема 5-2 Схема 5-3 Схема 5-4

б. След това мониторът започва да търси нулево налягане. Вижте схема 5-3.
в. Напомпайте маншета докато налягането е стигне стойности над Вашето нормално систолно налягане с 50 mmHg. В случай, че не знаете Вашето нормално систолно налягане, напомпете още маншета, така че да достигне до 190 mmHg. След това апаратът бавно освобождава въздуха от маншета и извършва измерването. Накрая кръвното налягане и скоростта на пулса ще се измерят и ще се покажат на екрана. Символът за аритмия на сърдечния ритъм ▮ (ако има такава) ще започне да мига. На екрана ще се появят един или няколко бара/вивици , показващи нивото на кръвното налягане. Вижте Схема 5-4.
г. След разчитане на резултатите, натиснете клапата за изпускане на въздух, която се намира в предната част на помпата, за да освободите въздуха.
д. Когато целият въздух е изтласкан от маншета, мониторът ще мига ⎍, тогава можете да започнете да измервате отново.
е. След измерване мониторът ще се изключи автоматично, в случай че не е използван за около 3 минути. Също така може да натиснете "START" бутона, за да изключите монитора ръчно.
ж. По време на измерването може да натиснете клапата за изпускане на въздух, която се намира в предната част на помпата, за да освободите въздуха.
з. Ако първоначално не сте напомпили достатъчно въздух в маншета всички числа на екрана ще изчезнат и ще се появи мигащ символ ▲ сочещ нагоре. В този случай е необходимо допълнително да напомпите въздух в маншета докато цифрите се покажат на екрана.

ⓘ **Забележка:** Моля, посъветвайте се с лекар за разчитане на резултатите от измерването на кръвното налягане.

ⓘ **Забележка:** Мониторът може да съхрани последния резултат. Ако смените батериите, последният резултат може да се загуби.

7.6. Засичане на аритмия

Появяването на символа ⎍ показва, че са открити неравности в сърдечния ритъм по време на измерването. Резултатът може да варира от Вашето нормално кръвно налягане. По принцип това не е причина за притеснение; все пак, ако символът ⎍ се появява по-често (например няколко пъти на седмица при ежедневни измервания) или ако изведнъж започне да се появява по-често от обикновено Ви препоръчваме да се консултирате с лекар.

7.7. Светлинна индикация

Цветните ленти от ляво на дисплея показват диапазона, в който се намират посочените стойности на кръвното налягане. В зависимост от получената височина, стойността за тълкуване е или в рамките на нормалната стойност (зелено), или е на "граница" (жълто и оранжево) или в категорията „опасност" (червено).
Тази класификация съответства на 6-те диапазона в Таблица, както са дефинирани от Европейското дружество по хипертония (ESH) и описани в Таблицата в точка 2. Препоръките на Европейското дружество по хипертония (ESH) позволяват диагностика и по-ефективно лечение на хипертонията и не противоречат на препоръките на Световната здравна организация.

7.8. Техническо описание на алармата

Мониторът незабавно показва 'HI' (високо) или 'Lo' (ниско) като аларма на дисплея, ако определеното кръвно налягане (систолно или диастолно) е извън дефинирания диапазон в СПЕЦИФИКАЦИИТЕ. В този случай, трябва да се консултирате с лекар или да проверите дали Вашите действия не нарушават дадените инструкции.
Условието за техническа тревога (извън разглеждания обхват) е предварително настроено от производителя и не може да се регулира или дезактивира. Това състояние на „тревога" се определя като ниськ приоритет съгласно IEC 60601-1-8. Техническата аларма не може да бъде блокирана и не се нуждае от пренастройка. Сигналът от дисплея изчезва автоматично след около 8 секунди.

7.9. Отстраняване на възникнали проблеми (1)

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Дисплеят показва символ за изтощена батерия ▭	Изтощена батерия	Сменете батериите
Дисплеят показва "Er 0"	Системата за налягане е нестабилна преди измерването	Не се движете и пробвайте отново
Дисплеят показва "Er 1"	Не успява да засече систолното налягане	
Дисплеят показва "Er 2"	Не успява да открие диастолно налягане	
Дисплеят показва "Er 3"	Пневматична система е блокирала или маншетът е прекалено стегнат	Поставете правилно маншета и пробвайте отново
Дисплеят показва "Er 4"	Разхерметизираност на пневматичната система или прекалено разхлабен маншет по време на напомпването	
Дисплеят показва "Er 5"	Налягане на маншета над 300mmHg	Измерете отново кръвното налягане след пет минути. Ако мониторът все още реагира необичайно, моля, свържете се с местния дистрибутор или производителя
Дисплеят показва "Er 6"	Повече от 3 минути с налягане на маншета над 15mmHg	
Дисплеят показва "Er 7"	EEPROM грешка при достъп	
Дисплеят показва "Er 8"	Грешка при параметрите на устройството	
Дисплеят показва "Er A"	Грешка при сензор за налягане	
Няма отговор при натискане на бутон или при зареждане на батерията	Неправилна операция или силни електромагнитни смущения	Извадете батериите за тел минути и след това ги инсталирайте отново

7.10. Отстраняване на възникнали проблеми (2)

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Дисплеят показва необичаен резултат	Позицията на маншета не е правилна или маншетът не е правилно пристегнат	Поставете маншета правилно и опитайте отново
	Положението на тялото по време на измерването е било неправилно	Прегледайте "Поза на тялото по време на измерването" в инструкциите и повторете теста
	Говор, неправилна позиция на ръката, тялото; раздразнение, вълнение или нервност по време на теста	Тествайте отново в спокойно състояние и без да говорите и да се движите по време на измерването
	Неравномерен сърдечен ритъм (аритмия)	Не е препоръчително хора с тежки аритмии да използват този монитор за измерване на кръвното налягане

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ⚠ Не изпускайте този уред и не го подлагйте на силни въздействия.
2. ⚠ Избягвайте висока температура и пряко излагане на такава. Не потапяйте монитора във вода, тъй като това би довело до повреда.
3. Ако мониторът се съхранява при много студена температура, оставете го да се акламатизира до стайна температура преди употреба.
4. ⚠ Не се опитвайте да разглобявате устройството.
5. Ако не използвате уреда дълго време, моля, извадете батериите.
6. Препоръчително е да се проверява работата на уреда на всеки 2 години или след ремонт. Моля, свържете се с центъра за обслужване.
7. Почиствайте уреда със суха, мека кърпа или мека кърпа, изцедена добре след намокряне с вода, с разреден дезинфектант или с разреден препарат.
8. Потребителят не може да поддържа компонентите на апарата. С апарата могат да бъдат доставени и диаграмите на веригата, списъците с отделни части, описания, инструкции за калибриране или друга информация, която подпомага подходящо квалифицирания технически персонал на потребителя при поправка на тези части на устройството, които са определени като „поправими".
9. Апаратът може да поддържа характеристиките за безопасност и работа при минимум 10,000 измервания или в продължение на три години и целостта на маншета – след 1000 цикъла „отваряне – затваряне" (поставяне – снемане).
10. Препоръчително е маншетът да се дезинфекцира 2 пъти седмично, ако е необходимо (например, в болница или в клиника). Избършете вътрешната страна на маншета (страната, която има допир с тялото) с мека кърпа, изцедена след навлажняване с етилов алкохол (75-90%), след това – оставете маншета да се проветри.
    Калъфът на маншета може да се пере на ръка при 30°C. Преди това внимателно извадете латексовата въздушна камера през специално проектирания отвор на калъфа.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не перете латексовата въздушна камера! Не гладете калъфа! Не е необходимо да се зашива специално проектирания отвор на калъфа на маншета!

9. СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Име на продукта: Blood Pressure Monitor /Апарат за кръвно налягане/
2. Модел: PRO-30.
3. Класифкация: с вътрешно захранване, BF приложена част, IPX0, No AP или APG, продължително действие.
4. Размер на апарата: 91 mm x 57 mm x 19 mm (3 19/32" × 2 1/4" × 3/4").
5. Обиколка на маншета: 22 см~42 см (8 21/32"~16 17/32") или 22 см~32 см (8 21/32"~ 12 19/32") (в зависимост от избора на апарат).
6. Тегло: прибл. 50 g (2 1/2 oz.) (без включени батерии и маншет)
7. Метод на измерване: осцилометричен метод, напомпване с въздух и измерване.
8. Обем на паметта: запаметява се само последното измерване.
9. Източник на енергия: DC 6V ⎓ 600 mA, батерии: 2 × 1.5V Размер AAA.
10. Обхват на измерването
    Налягане на маншета: 0-300mmHg
    Систолично: 60-280mmHg
    Диастолично: 40-199mmHg
    Честота на пулса: 40-180 удара/минута
11. Точност: Налягане: ±3mmHg
    Скорост на пулса: ±5%
12. Температура на околната среда при работа: 10°C~40°C (50°F~104°F)
13. Влажност на околната среда при работа: ≤85% RH
14. Температура на околната среда при съхранение и транспорт: -20°C~50°C(-4°F~122°F)
15. Влажност на околната среда при съхранение и транспорт: ≤85% RH
16. Налягане на околната среда: 80KPa-105Kpa
17. Издръжливост на батерията: приблизително 270 пъти
18. Апарат за кръвно налягане /комплект/: M-L размер на маншета (обиколка на маншета 22 - 42 см) или M размер (обиколка 22 - 32 см) (а апарат), калъф за съхранение, батерии AAA – 2 броя, инструкции.

ⓘ **Забележка:** Тези спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

10. ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ

Цифровият апарат за измерване на кръвното налягане отговаря на посочените по-долу стандарти:
IEC 60601-1: 2005 / EN 60601-1: 2006 / AC: 2010 (Медицинско електрическо оборудване. Част 1: Общи изисквания за безопасност и основна работа на уреда)
IEC60601-1-2: 2007 / EN 60601-1-2: 2007 / AC: 2010 (Медицинско електрическо оборудване. Част 1: Общи изисквания за безопасност и основна работа на уреда – Вторичен стандарт: Електромагнитна съвместимост – Изисквания и изпробване),
IEC 80601-2-30: 2009 + Cor.2010 (Медицинско електрическо оборудване – Част 2-30: Специфични изисквания за безопасност и основна работа на автоматизирани неинвазивни сфигмоманометри),
EN 1060-1: 1995 + A1: 2002 + A2: 2009 (Неинвазивни сфигмоманометри – Част 1: Общи изисквания)
EN 1060-3: 1997 + A1: 2005 + A2: 2009 (Неинвазивни сфигмоманометри – Част 3: Допълнителни изисквания при електромеханичните системи за измерване на кръвно налягане).

11. ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

- ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИЯ НАРЪЧНИК С ИНФОРМАЦИЯ. (Фон на символа: син. Графичен символ: бял)
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- ПРИЛОЖИМИ ЧАСТИ ВИД BF (Маншетът е приложима част ВИД BF)
- ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – Отпадъците от електрически продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте, ако има съоръжения за това. Потърсете съвет относно рециклирането от местните власти или с търговец на дребно
- ИМЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- REF НОМЕР НА АРТИКУЛ
- MD МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ
- SN СЕРИЕН НОМЕР
- CE 0044 0044 CE обозначение (0044) съответства на изискванията на MDD93/42/EEC
- 10°C~40°C OPERATION CONDITION УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА, ТЕМПЕРАТУРА 10°C ~ 40°C
- -20°C~50°C STORAGE CONDITION СЪХРАНЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА -20°C ~ 50°C
- НЕ МОКРЕТЕ
- IP20 ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА
- UDI УНИКАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УСТРОЙСТВОТО
- EC REP ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕО

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА

Гаранционният срок е **3 години** от датата на закупуване на апарата и 1 година за маншет. Тази гаранция НЕ покрива нанесени щети, причинени от неправилна употреба, а също и във връзка с батерията и опаковката. При откриване на производствен дефект по време на гаранционния период, дефектната част може да бъде ремонтирана или ако е невъзможно да бъде поправена, да бъде заменена с друга.
Гаранцията не покрива компоненти и консумативи,подлежащи на естествено износване, както и батерии и опаковки на изделието.

IM_PRO30_BG_4822

Серийният номер съдържа датата на производство: WWYYXXXXX. Производителят има правото да променя без предупреждение частично или напълно определени компоненти, ако това е необходимо.

13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

Таблица 1
За всички видове ME (електромеханично) ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМИ

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитни емисии

PRO-30 е предназначен за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу. Купувачът или потребителят на апарат PRO-30 трябва да се увери, че използва апарата в точно определената за целта среда.

Тест емисии	Съответствие	Електромагнитна среда – насоки
RF емисии CISPR 11	Група 1	Апаратът PRO-30 използва RF енергия само за вътрешнифункции. Следователно, неговите RF емисии са много малки и няма вероятност да причинят намеса в електронното оборудване, разположено в близост.
RF емисии CISPR 11	Клас B	Апаратът PRO-30 е подходящ за използване във всякакви условия, включително и в домашни, и такива директно свързани с мрежата за обществено снабдяване на електричество, която доставя електричество на сгради използвани за битови нужди.
Звукови емисии IEC 61000-3-2	Неприложимо	
Вариране в напрежението/ емисии на трептене IEC 61000-3-3	Неприложимо	

Таблица 2
За ME (електромеханично) ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМИ

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитни емисии

PRO-30 е предназначен за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу. Купувачът или потребителят на апарат PRO-30 трябва да се увери, че използва апарата в точно определената за това среда.

Тест за имунитет/ устойчивост	IEC 60601 ниво на теста	Ниво на съответствие	Електромагнитна среда – ръководство
Електростатичен разряд (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV контакт ± 8 kV въздух	± 6 kV контакт ± 8 kV въздух	Подовете трябва да бъдат от дърво, бетон или керамични плочки. Ако подове са покрити с изкуствен материал, относителната влажност на въздуха трябва да е поне 30%.
Честота на захранването (50/60 Hz) магнитно поле IEC 61000-4-8	3 A/м	3 A/м	Магнитни полета свързани с честотата на електричеството трябва да са на нива, характерни за типичната търговска или болнична среда.

ЗАБЕЛЕЖКА: UT е основният а.с. волтаж преди прилагането на съответното ниво на теста.

Таблица 3
За ME (електромеханично) ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМИ, който не са животоподдържащи

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитен имунитет

PRO-30 е предназначен за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу. Купувачът или потребителят на апарат PRO-30 трябва да се увери, че използва апарата в точно определената за това среда.

Тест за устойчивост	IEC 60601 ниво на теста	Ниво на съответствие	Електромагнитна среда – ръководство
Излъчени RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz до 2,5 GHz	3 V/m	Преносимото и мобилно RF оборудване за комуникации, разположено в близост, до която и да е част на PRO-30, включително кабели, трябва да е отдалечено на препоръчителното разстояние, изчислено по уравнението за честота на предавателя. **Препоръчително разстояние:** d=1,2√P d=1,2√P 80 MHz to 800 MHz d=2.3√P 800 MHz to 2,5 GHz *Когато P е максималното ниво на изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя и d е препоръчителното разстояние в метри (m).* Напрежението на полето от фиксираните радиочестотни предаватели, както е дефинирано при проучването на електромагнитното поле,а трябва да бъде по-малко отколкото нивото на съответствие за всяка честотна гама.b Възможна е появата на интерференция в близост до уреда, която се обозначава със следния знак:

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz, се прилага гама с по-висока честота.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези насоки не могат да бъдат прилагани във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от тяхната абсорбция и отражение от конструкции, предмети и хора.

a. Полевото напрежение от фиксирани предаватели, такива като базови радио (клетъчни/ безжични) телефони и мобилни земни радиостанции, аматьорско радио, AM и FM радио предавания и телевизионни излъчвания не може да бъде предсказано теоретично с точност. За да се направи оценка на електромагнитната среда, свързана с фиксираните радиопредаватели, трябва да бъде планирано проучване на електромагнитната площадка/сайт. Ако измерената сила на полето на мястото, където се използва PRO-30 надхвърля необходимото описано радиочестотно ниво, апаратът PRO-30 трябва да бъде наблюдаван, за да се гарантира неговото нормално функциониране. Ако се установи необичайно функциониране на апарата, може да се наложи да се предприемат допълнителни мерки, като например преориентиране или преместване на апарата PRO-30.
b. Над следната честота 150 kHz до 80 MHz, силата на полето не трябва да надвишава [V1] V/m.

Таблица 4
За ME (електромеханично) ОБОРУДВАНЕ и СИСТЕМИ, които не са ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ

Препоръчително разстояние между преносима и мобилна радиочестотна комуникационна техника и апарат PRO-30

PRO-30 е предназначен за използване в електромагнитна среда, в която се контролират излъчваните радиочестотни смущения. Клиентът или потребителят на апарат PRO-30 може да съдейства за предотвратяване на електромагнитни смущения, като поддържа минимално разстояние между преносимото и мобилно радиочестотно комуникационно оборудване (предаватели) и PRO-30 в съответствие с препоръките, указани по-долу, в зависимост от максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимална изходна мощност на предавателя W	Разделително разстояние според честотата на предавателя, м		
	150 kHz to 80 MHz d = 1.2√P	80 MHz to 800 MHz d = 1.2√P	800 MHz to 2,5 GHz d = 2.3√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

*За предаватели с максимална мощност, която не е описана по-горе, препоръчителното разделително разстояние **d** в метри (m) може да се определи с помощта на приложимото уравнение в зависимост от честотата на предавателя, където **P** е максималното ниво на изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя.*

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделителното разстояние както при по-високата честота.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези насоки не могат да бъдат прилагани във всички ситуации. Разпространението на електромагнитните вълни се влияе от тяхната абсорбция и отражение им от сгради, предмети и хора.

Последна редакция 2022-W48

Вносител за България – Вега 96 ЕООД,
Хасково, бул. Освобождение 111, тел.0035938651173,
моб.00359895795920

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24,
9443 Widnau, Switzerland

B.Well
Caring for everyone